
Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.piterflow.nt-rt.ru || эл. почта: pwf@nt-rt.ru

Назначение и принцип действия

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б (далее **КТС-Б**), предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения.

Комплекты КТС-Б подбираются из термопреобразователей сопротивления ТС-Б (далее ТС-Б), изготовленных согласно ТУ РБ 390184271.001-2003, с рабочим диапазоном измеряемых температур (0-180) °C.

Основные технические характеристики КТС-Б

- Диапазон измеряемых температур от 0 до 160 °C.
- Диапазон измеряемых разностей температур от Δt_{\min} до 150 °C, где $\Delta t_{\min} = 2$; 3 °C – минимальная разность температур.
- Относительная погрешность измерения разности температур $\delta_{\Delta t}$, выраженная в процентах, не превышает значений определенных по формуле

$$\delta_{\Delta t} = \pm \left(0,5 + \frac{3 \cdot \Delta t_{\min}}{\Delta t} \right)$$

где $\Delta t_{\min}=2$; 3 – минимальная разность температур, °C;

Δt – измеряемая разность температур, °C.

Таблица 1

Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ)	R_0 , Ом	Рекомендуемый измерительный ток, мА	W_{100}
Pt'50	50	1	1,3910
Pt'100	100		
Pt'500	500	0,2	1,3850
Pt100	100		
Pt500	500	0,2	
Pt1000	1000		

R_0 – номинальное значение сопротивления при 0 °C;
 W_{100} – номинальное значение отношения сопротивления при 100 °C к R_0 .

Таблица 2

Класс допуска по ГОСТ 6651-94	Допускаемое отклонение сопротивления при 0 °C от R ₀ , %	Пределы допускаемых отклонений сопротивления от НСХ, °C
A	0,05	±(0,15 + 0,002 · t)
B	0,1	±(0,3 + 0,005 · t)

Условия эксплуатации комплектов КТС-Б

- **КТС-Б** устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C, к воздействию влажности окружающего воздуха 95 % при 35 °C и более низких температурах (группа ДЗ ГОСТ 12997).

- **КТС-Б** устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц, с амплитудой смещения 0,35 мм, группа исполнения N2 ГОСТ 12997.

Конструктивные исполнения

КТС-Б представляет собой пару подобранных термопреобразователей сопротивления ТС-Б. Конструктивное исполнение термопреобразователей сопротивления ТС-Б, а равно и **КТС-Б**, в первую очередь, определяется моделью.

Модель **КТС-Б** определяется:

- исполнением монтажной части (см. табл. 3);
- исполнением крепежной части (см. табл. 4);
- исполнением клеммной головки (см. табл. 5).

Основные модели **КТС-Б** приведены в таблице 6.

Материал защитной арматуры - сталь 12Х18Н10Т. По согласованию с заказчиком могут применяться другие материалы защитной арматуры.

Таблица 3 – Исполнения монтажной части

Вариант исполнения монтажной части	Условное обозначение	Изображение	Диаметр монтажной части D, мм	Длина монтажной части L _m , мм	
			min	max	
Погружающаяся	П	 прямая	4	30	120
			5	40	320
			6	50	500
			8	60	500

Таблица 4 – Исполнения крепежной части

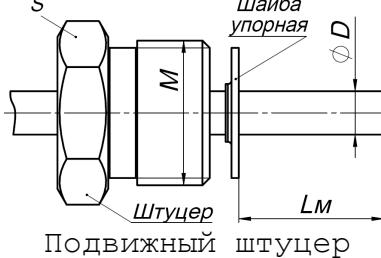
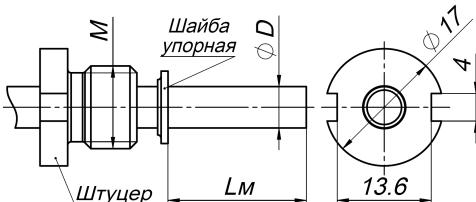
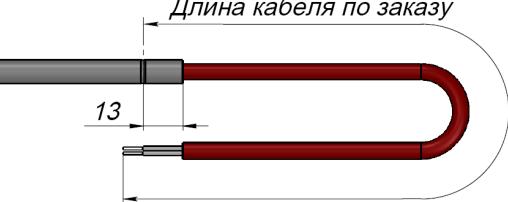
Предпочтительные и наиболее распространенные исполнения крепежной части КТС-Б это «Без элементов крепления» и «ПШ подвижный штуцер» с резьбой M20x1,5.			
Условное обозначение	Изображение, описание	M	D, мм
отсутствует	Без элементов крепления Исполнения см. табл.6 Основные модели КТС-Б	-	см. табл.6
ПШ	 Подвижный штуцер	M12x1,5; G1/4"	4; 6
		M16x1,5; G3/8"	6; 8; 10
		M20x1,5; G1/2"	6; 8; 10
ПШп	 Подвижный штуцер, конструкция «штуцер с пазами»	M12x1,5; G1/4"	4
Примечание – Размер шестигранника S определяется изготавителем, длина монтажной части Lm по заказу.			

Таблица 5 – Исполнения клеммных головок

Условное обозначение	Изображение и описание	Степень защиты IP
A	 Без клеммной головки КТС-Б с проводами	IP00
Б	 Без клеммной головки КТС-Б с кабелем	IP65

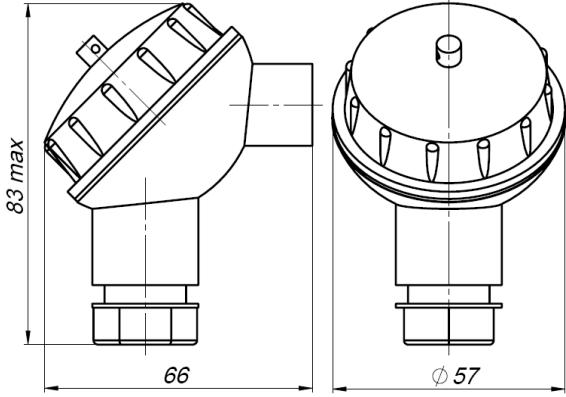
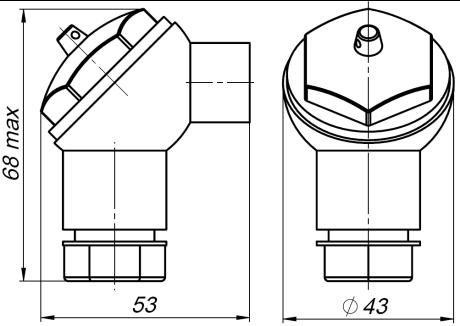
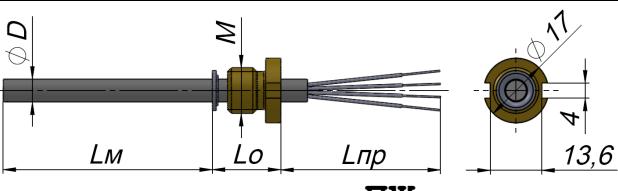
E	 «Большая» пластиковая клеммная головка	IP65
Ж	 «Малая» пластиковая клеммная головка	IP65

Таблица 6 – Основные модели КТС-Б

КТС-Б с проводами А				
Отношение сопротивлений W_{100}	$W_{100}=1,3850$	$W_{100}=1,3910$		
НСХ	Pt100; Pt500; Pt'50; Pt'100; Pt1000	Pt'500		
Класс допуска	A, B			
Условное обозначение схемы внутренних соединений (см. табл.7)	x2, x3, x4			
Минимальная разность температур, °C	2; 3			
				
 Крепление ПШП				
Без элементов крепления				
L_m , мм	48, 50, 60, 80			
D , мм	4			
L_m , мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320			
D , мм	4 (L_m не более 120 мм); 6			
L_{pr} , мм	100, 180, 200, 250, 500, 1000, 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3500, 4000, 4500, 5000			
L_o , мм	25			
M	M12x1,5			
L_{pr} , мм	100, 180, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000			
По согласованию с заказчиком, возможно изготовление КТС-Б с размерами отличными от приведенных.				

Примеры записи условного обозначения **KTC-Б с проводами А**, при заказе:

Без элементов крепления

«Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых
KTC-Б-Pt100-В-х4-П-3-80/6-А-500

ТУ РБ 390184271.003 – 2003», что означает, комплект термопреобразователей сопротивления платиновых **KTC-Б**, с НСХ **Pt100**, классом допуска **В**, с одним чувствительным элементом, с четырехпроводной схемой внутренних соединений **х4**, с погружаемой монтажной частью **П**, с минимальной измеряемой разностью температур **3 °C**, с длиной монтажной части **Lm = 80** мм, диаметром монтажной части **D = 6** мм, без элементов крепления, с проводами **А**, длина проводов **500** мм.


С элементами крепления

«Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых
KTC-Б-Pt100-В-х4-П-3-80/6-Шп.25.М12x1,5-А-500

ТУ РБ 390184271.003 – 2003», что означает, комплект термопреобразователей сопротивления платиновых **KTC-Б**, с НСХ **Pt100**, классом допуска **В**, с одним чувствительным элементом, с четырехпроводной схемой внутренних соединений **х4**, с погружаемой монтажной частью **П**, с минимальной измеряемой разностью температур **3 °C**, с длиной монтажной части **Lm = 80** мм, диаметром монтажной части **D = 6** мм, с креплением подвижный штуцер конструкция «штуцер с пазами» **Шп**, с длиной наружной части **Lo = 25** мм, с резьбой штуцера **M12x1,5**, с проводами **А**, длина проводов **500** мм.

KTC-Б с кабелем Б

Отношение сопротивлений W_{100}	$W_{100}=1,3850$	$W_{100}=1,3910$
НСХ	Pt100; Pt500; Pt1000	Pt'50; Pt'100; Pt'500
Класс допуска	A, В	
Условное обозначение схемы внутренних соединений (см. табл.7)	х2, х3, х4	
Минимальная разность температур, °C	2; 3	

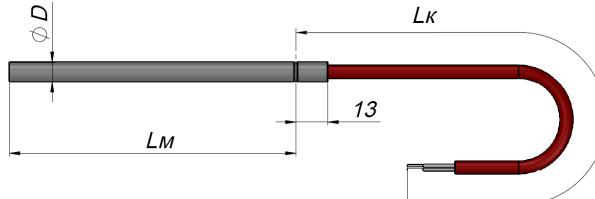

Без элементов крепления

Lm, мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
D, мм	4 (Lm не более 120 мм); 6
Lk, мм	500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000



По согласованию с заказчиком, возможно изготовление KTC-Б с размерами отличными от приведенных.

Примеры записи условного обозначения **KTC-Б с кабелем Б**, при заказе:

Без элементов крепления

«Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых
KTC-Б-Pt100-В-х4-П-3-120/6-Б-1500

ТУ РБ 390184271.003 – 2003», что означает, комплект термопреобразователей сопротивления платиновых **KTC-Б**, с НСХ **Pt100**, классом допуска **В**, с одним чувствительным элементом, с четырехпроводной схемой внутренних соединений **х4**, с погружаемой монтажной частью **П**, с минимальной измеряемой разностью температур **3 °C**, с длиной монтажной части **Lm = 120** мм, диаметром монтажной части **D = 6** мм, без элементов крепления, с кабелем **Б**, длина кабеля **1500** мм.

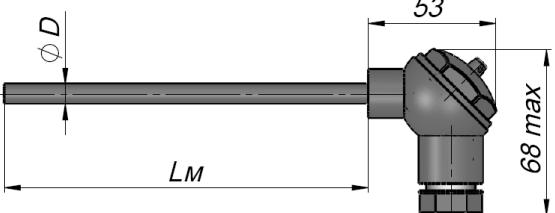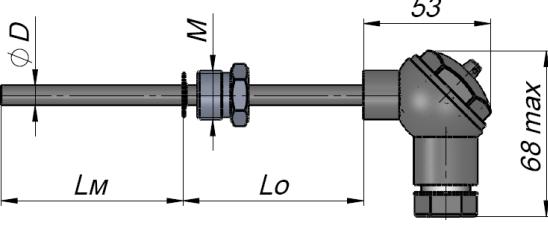КТС-Б с клеммной головкой Ж						
Отношение сопротивлений W_{100}	$W_{100}=1,3850$	$W_{100}=1,3910$				
НСХ	Pt100; Pt500; Pt1000	Pt'50; Pt'100; Pt'500				
Класс допуска	A, B					
Условное обозначение схемы внутренних соединений (см. табл.7)	x2, x3, x4					
Минимальная разность температур, °C	2; 3					
 Без элементов крепления <p>Длина погружаемой части должна быть меньше длины монтажной части Lm на 50 мм или более</p>						
 Крепление ПШ <table border="1"> <tr> <td>Lm, мм</td><td>60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500</td></tr> <tr> <td>D, мм</td><td>6 (Lm не более 320 мм); 8 (Lm не более 1000 мм); 10</td></tr> </table>			Lm, мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500	D, мм	6 (Lm не более 320 мм); 8 (Lm не более 1000 мм); 10
Lm, мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500					
D, мм	6 (Lm не более 320 мм); 8 (Lm не более 1000 мм); 10					
Lm, мм	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500	Lo, мм	50; 120			
D, мм	4; 6 (Lm не более 320 мм); 8 (Lm не более 1000 мм); 10	M, мм	M20x1,5; резьба заказчика*			
<p>*резьбы в соответствии с табл. 4, либо другие, после дополнительного согласования.</p> <p>По согласованию с заказчиком, возможно изготовление КТС-Б с размерами отличными от приведенных.</p>						
Примеры записи условного обозначения КТС-Б с клеммной головкой Ж, при заказе:						
Без элементов крепления «Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б-Pt100-В-х4-П-3-120/8-Ж						
ТУ РБ 390184271.003 – 2003», что означает, комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б, с НСХ Pt100, классом допуска В, с одним чувствительным элементом, с четырехпроводной схемой внутренних соединений х4, с погружаемой монтажной частью П, с минимальной измеряемой разностью температур 3 °C, с длиной монтажной части Lm = 120 мм, диаметром монтажной части D = 8 мм, без элементов крепления, с пластиковой клеммной головкой Ж.						
С элементами крепления «Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б-Pt100-В-х4-П-3-80/8-ПШ.50.M20x1,5-Ж						
ТУ РБ 390184271.003 – 2003», что означает, комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б, с НСХ Pt100, классом допуска В, с одним чувствительным элементом, с четырехпроводной схемой внутренних соединений х4, с погружаемой монтажной частью П, с минимальной измеряемой разностью температур 3 °C, с длиной монтажной части Lm = 80 мм, диаметром монтажной части D = 8 мм, с креплением подвижный штуцер ПШ, с длиной наружной части Lo = 50 мм, с резьбой штуцера M20x1,5, с пластиковой клеммной головкой Ж.						

КТС-Б с клеммной головкой Е

Отношение сопротивлений W_{100}	$W_{100}=1,3850$	$W_{100}=1,3910$		
НСХ	Pt100; Pt500; Pt1000	Pt'50; Pt'100; Pt'500		
Класс допуска	A, B			
Условное обозначение схемы внутренних соединений (см. табл. 7)	x_2, x_3, x_4			
Минимальная разность температур, °C	2; 3			
Крепление ПШ				
Без элементов крепления Длина погружаемой части должна быть меньше длины монтажной части L_m на 50 мм или более	L_m , мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500		
	D , мм	6 (L_m не более 320 мм); 8 (L_m не более 1000 мм); 10		
L_m , мм	L_o , мм	50; 120		
D , мм	M , мм	M20x1,5; резьба заказчика*		

*резьбы в соответствии с табл. 4, либо другие, после дополнительного согласования.

По согласованию с заказчиком, возможно изготовление КТС-Б с размерами отличными от приведенных.

Примеры записи условного обозначения КТС Б с клеммной головкой Е, при заказе:

Без элементов крепления

«Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых

КТС-Б-Pt100-B-x4-P-3-120/8-E

ТУ РБ 390184271.003 - 2003», что означает, комплект термопреобразователей сопротивления платиновых **КТС-Б**, с НСХ **Pt100**, классом допуска **B**, с одним чувствительным элементом, с четырехпроводной схемой внутренних соединений **x4**, с погружаемой монтажной частью **П**, с минимальной измеряемой разностью температур **3 °C**, с длиной монтажной части $L_m = 120$ мм, диаметром монтажной части $D = 8$ мм, без элементов крепления, с пластиковой клеммной головкой **E**.

С элементами крепления

«Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых

КТС-Б-Pt100-B-x4-P-3-80/8-ПШ.50.M20x1,5-E

ТУ РБ 390184271.003 - 2003», что означает, комплект термопреобразователей сопротивления платиновых **КТС-Б**, с НСХ **Pt100**, классом допуска **B**, с одним чувствительным элементом, с четырехпроводной схемой внутренних соединений **x4**, с погружаемой монтажной частью **П**, с минимальной измеряемой разностью температур **3 °C**, с длиной монтажной части $L_m = 80$ мм, диаметром монтажной части $D = 8$ мм, с креплением подвижный штуцер **ПШ**, с длиной наружной части $L_o = 50$ мм, с резьбой штуцера **M20x1,5**, с пластиковой клеммной головкой **E**.

Схемы электрических цепей


Таблица 7 – Схемы внутренних соединений КТС-Б

 x2 двухпроводная схема, один ЧЭ	 x3 трехпроводная схема, один ЧЭ	 x4 четырехпроводная схема, один ЧЭ
---	---	--

Гильзы для монтажа КТС-Б

Таблица 8

КТС-Б с кабелем, без элементов крепления

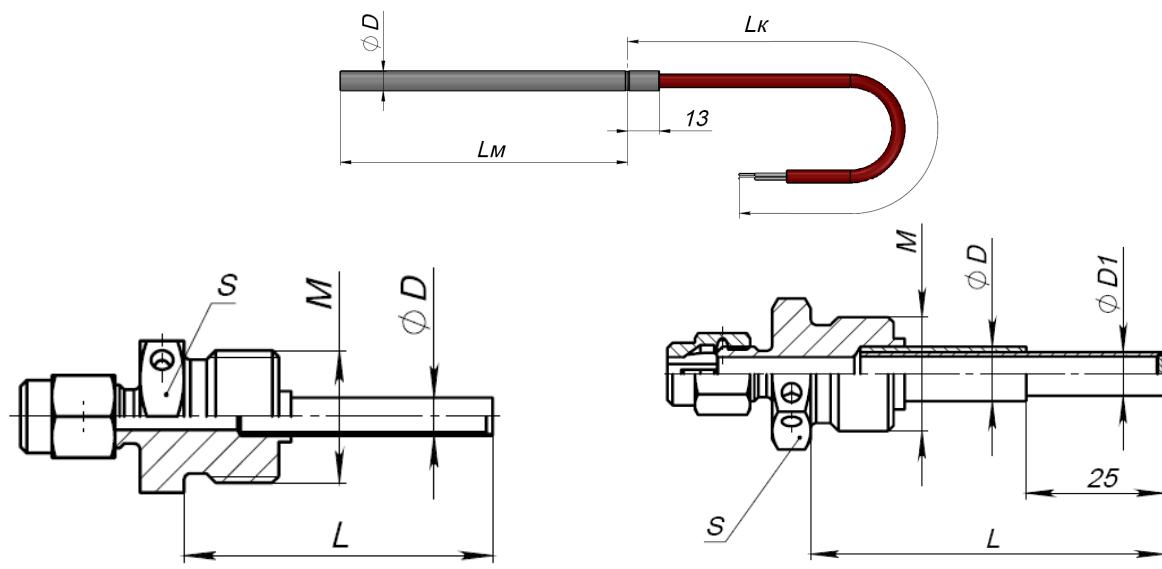


Гильза ГЦР.107*

Гильза ГЦР.108*

(усиленная монтажная часть)


Крепление в гильзе осуществляется с помощью цанги обжимающей кабель.

КТС-Б со штуцером

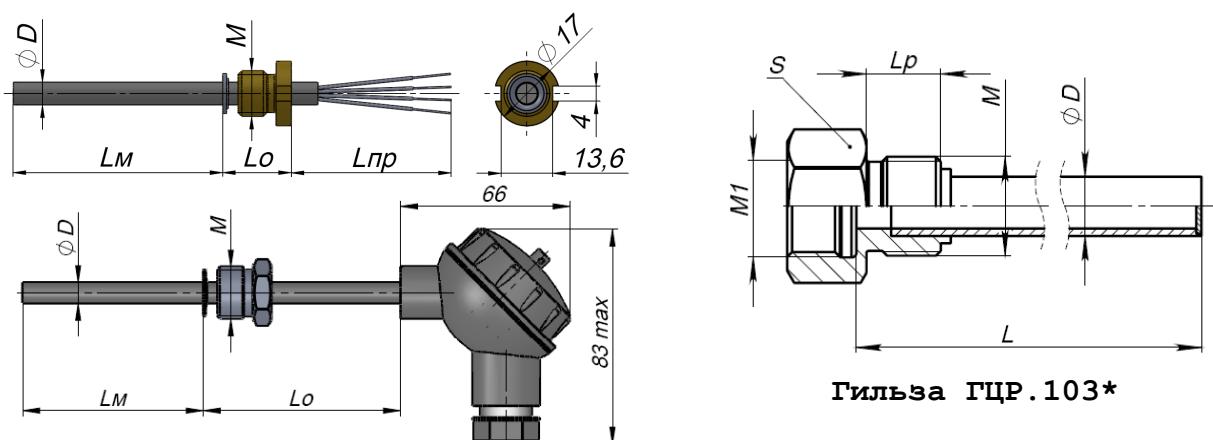

Крепление в гильзе осуществляется с помощью подвижного штуцера.

**КТС-Б с проводами, КТС-Б с кабелем, КТС-Б с клеммной головкой
без элементов крепления**

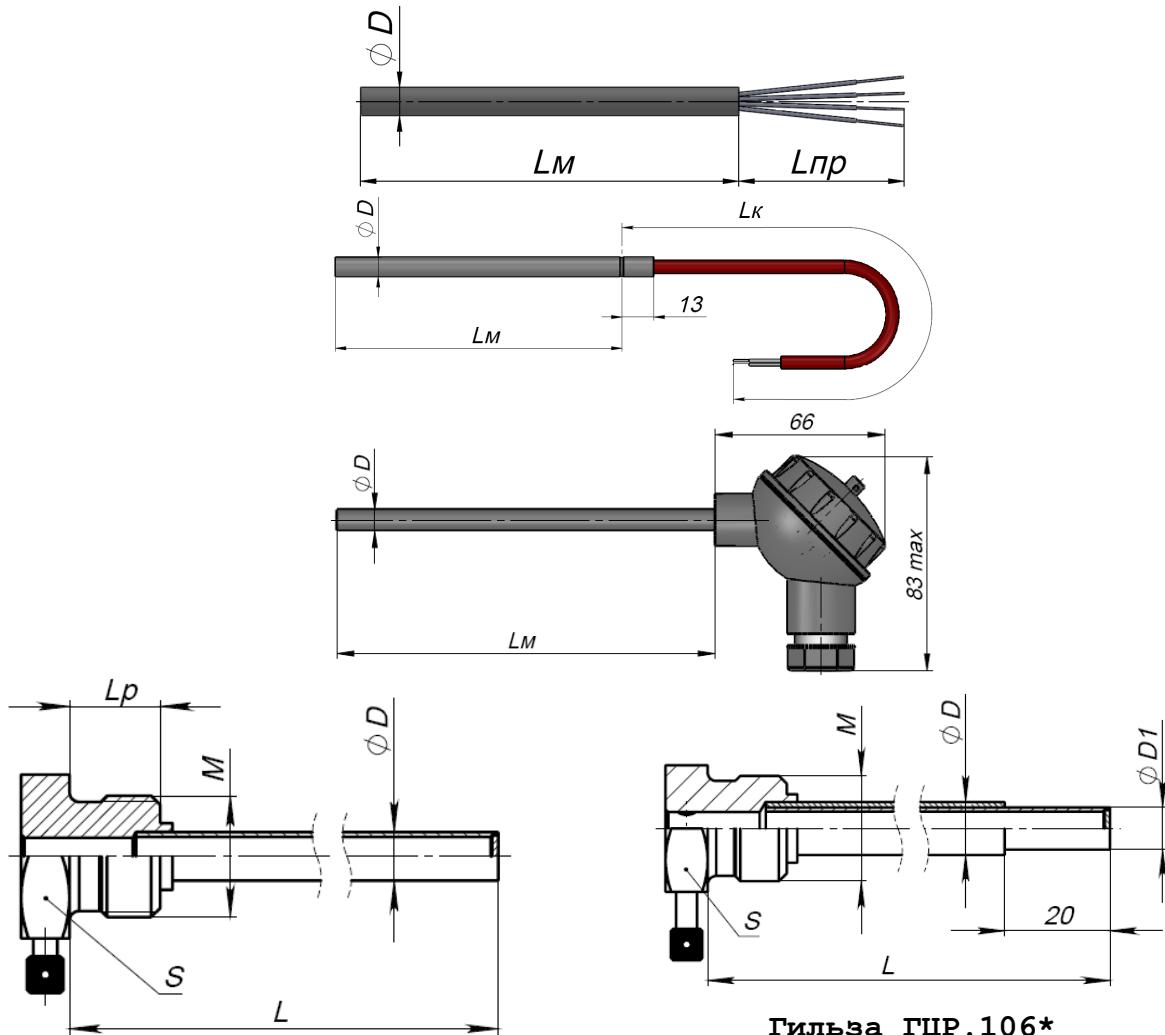

Гильза ГЦР.105*

(усиленная монтажная часть)

Крепление в гильзе осуществляется с помощью винта гильзы.

*Подробное описание конструкций гильз и схемы их заказа, приведены в разделе «Гильзы термометрические» общего каталога изделий ООО «Поинт» либо в отдельном каталоге «Гильзы термометрические».

Схема условного обозначения КТС-Б (схема заказа)

пример записи условного обозначения:

КТС-Б - Pt100 -В -x4 -П - 3 - 80 /6 - ПШ. 50. M20x1,5 -Е -1000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Параметр	Возможные значения
1. Обозначение типа	КТС-Б
2. НСХ	Pt100 Pt'50 Pt500 Pt'100 Pt1000 Pt'500
3. Класс допуска	A, B
4. Схема электрических соединений (табл. 6, 7)	x2, x3, x4
5. Исполнение монтажной части (табл. 3; 6)	П
6. Минимальная разность измеряемых температур Δt_{min} , °C	2; 3
7. Длина монтажной части L _m (см. табл. 6), мм*	35, 40, 48, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
8. Диаметр монтажной части D (см. табл. 6), мм*	4; 6; 8; 10
9. Тип крепления (см. табл. 4, 6)	ПШ, ПШп (при отсутствии не указывается)
10. Длина наружной части L _o (см. табл. 6), мм	50, 120 (при отсутствии не указывается)
11. Типоразмер крепления (см. табл. 4, 6)	M12x1,5; M16x1,5; M20x1,5; G1/4; G3/8; G1/2 (при отсутствии не указывается)
12. Исполнение клеммной головки (см. табл. 5, 6)	А, Б, Е, Ж
13. Длина кабеля или проводов, L _k или L _{pr} (см. табл. 6), мм	100, 180, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 (при отсутствии не указывается; в примере записи условного обозначения, длина кабеля 1000 мм приведена для примера, стандартное исполнение КТС-Б, с головкой Е - без кабеля)

Внимание!

1 *При составлении условного обозначения следует руководствоваться разделом «Конструктивные исполнения» и приведенными примерами в таблице 6.

2 По согласованию с заказчиком, возможно изготовление КТС-Б с длиной и диаметром монтажной части, наружной части, типоразмером крепления, длиной кабеля или проводов отличными от приведенного ряда.

Примеры записи условного обозначения КТС-Б приведены в разделе «Конструктивные исполнения» таблица 6 !

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.piterflow.nt-rt.ru || эл. почта: pwf@nt-rt.ru